

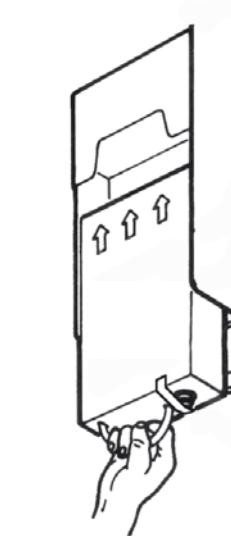
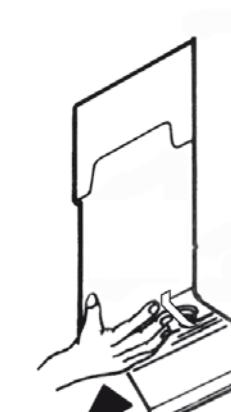


For storage and

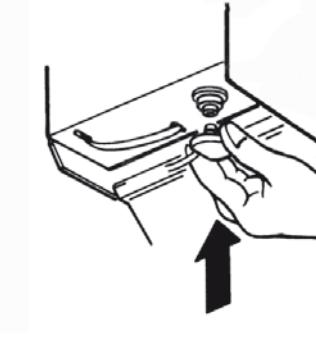

Minipack AD60

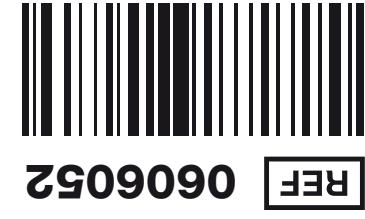

REF 0606052



WASTE



Warning, remove the 4 red caps before use.

A01A00230A

REAGENT 1 1 x 0,5 L

- Reagent for *in vitro* diagnostic use as a cleaning solution on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* en tant que solution de nettoyage sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro-Diagnostikum (Reinigungslösung)* für das ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per uso diagnostico *in vitro* come soluzione detergente per il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como solución limpiaadora en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como solução de limpeza no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering som rengøringsoplosning på ADVIA 60 Hämatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnosrik som rengöringslösning med ADVIA 60 hematologisystem.

REAGENT 2 1 x 0,3 L

- Reagent for *in vitro* diagnostic use as an erythrocyte-lysing agent for white blood cell counting, differentiation, and hemoglobin determination on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* en tant qu'agent de lyse érythrocytaire pour la numération et la différenciation des leucocytes, et la détermination de l'hémoglobine sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro-Diagnostikum (erythrozytenlyserende Lösung)* zur Zählung der weißen Blutkörperchen, Differenzierung und Hämoglobinbestimmung für das ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per uso diagnostico *in vitro* come agente lisante degli eritrociti per applicazione nella conta e differenziazione leucocitaria e la determinazione dell'emoglobina con il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como agente de lisis de eritrocitos para el recuento de leucocitos, la diferenciación y la determinación de hemoglobina en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como lisante de eritrócitos para contagem de leucócitos, diferenciação e determinação de hemoglobina no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering som erytrocytlyserende middel til tælling af hvide blodceller, differentialtælling og hæmoglobinbestemmelse på ADVIA 60 Hämatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnosrik som erytrocytlyserande medel för räkning av vita blodceller, differentiering och hemoglobinbestämning med ADVIA 60 hematologisystem.

REAGENT 3 1 x 3,4 L

- Reagent for *in vitro* diagnostic use in the determination and differentiation of blood cells and the measurement of hematocrit on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* pour la détermination et la différenciation des cellules sanguines et la mesure de l'hématocrite sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro-Diagnostikum* zur Bestimmung und Differenzierung von Blutkörperchen sowie zur Hämatokritmessung mit dem ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per l'impiego diagnostico *in vitro* per la determinazione e la differenziazione delle cellule ematiche e per la misurazione dell'emato crito con il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* en la determinación y la diferenciación de células sanguíneas y en la medición del hematocrito en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* na determinação e na diferenciação de células sanguíneas e na medição de hematocritos no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering ved bestemmelse og differentialtælling af blodceller samt måling af hæmatokrit på ADVIA 60 Hämatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnosrik vid bestämning och differentiering av blodkroppar och mätning av hematokrit med ADVIA 60 hematologisystem.

18°C 25°C Store at 18/25°C

IVD CE R52

Tel. + 800 67 14 15 16

www.horiba-abx.com/documentation

Made in France

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4 / France